


表

令和8年8月18日開札
「血液培養自動分析装置」
入札書第1回目在中
入札者の商号（名称） ○○○○○○○○○

裏（封筒の貼り合わせの2か所に押印すること）

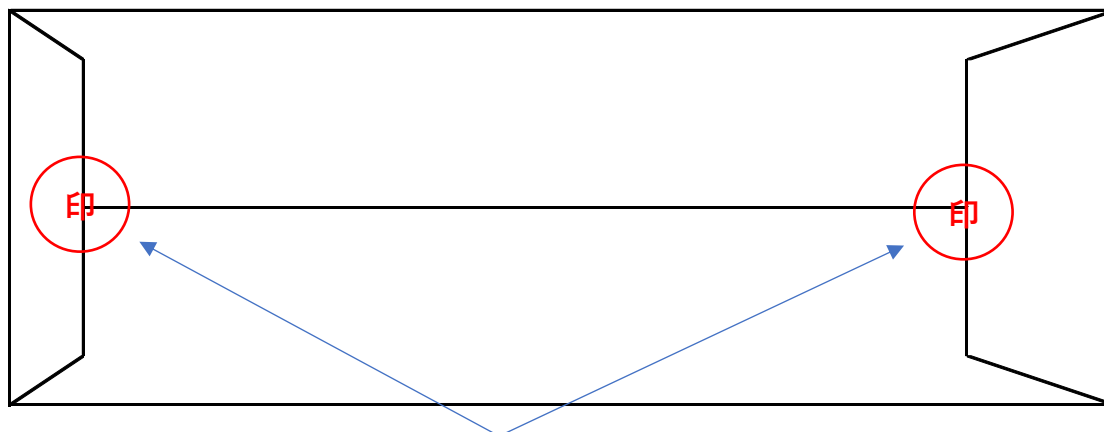

封印に利用する印鑑は、入札書に押印した印鑑と同じものを使用すること